

# TURB-2A(1000)浊度仪说明书

## 一、 原理

浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。

本浊度仪采用 90° 散射光原理。

由光源发出的平行光束通过溶液时，一部分被吸收和散射，另一部分透过溶液。与入射光成 90° 方向的散射光强度符合雷莱公式：

$$I_s = \frac{K N V^2}{\lambda} \times I_0$$

其中：  $I_0$  —— 入射光强度

$I_s$  —— 散射光强度

N —— 单位溶液微粒数

V —— 微粒体积

$\lambda$  —— 入射光波长

K —— 系数

在入射光恒定条件下，在一定浊度范围内，散射光强度与溶液的混浊度成正比。上式可表示为：

$$\frac{I_s}{I_0} = K' N \quad (K' \text{ 为常数})$$

根据这一公式，可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度。


## 二、 主要技术性能

本浊度仪是高精度测量仪，采用四位 LED 数字显示，具有自动切换量程，稳定准确，使用方便等特点。广泛适用于食品、石油、化工、环境监测、医疗卫生等部门行业。

1. 测量范围：0~1000 度。分 0~5、5~25、25~100、100~400、400~800、800~1000 度六个量程。
2. 精确度： $\leq \pm 2\%$  (满量程)
3. 重现性： $\leq \pm 2\%$  (满量程)
4. 分辨率：0.01 NTU
5. 每小时漂移： $< 0.1$  NTU
6. 外形尺寸：282mm×237mm×102mm
7. 重量：2.2kg
8. 仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：


- (1) 环境温度: 5~40°C
- (2) 相对湿度: ≤70%
- (3) 供电电源: AC(220±10%)V; 50Hz
- (4) 避免强光直接照射, 无显著的振动及强电磁干扰

### 三、 结构

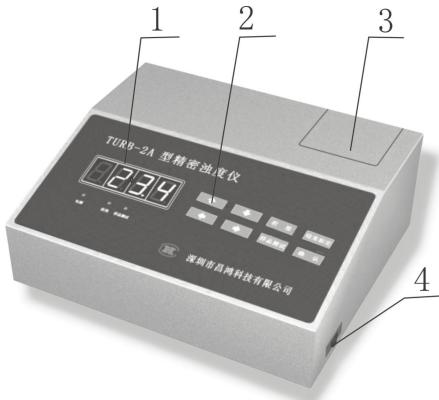

图一 前面板示意图

1. LED 显示屏
2. 键盘
  - ① “↑”、“↓”: 在标定或校准曲线时, 按两键可更改 (0~9) 的数字大小。
  - ② “←”、“→” 键: 在标定或校准曲线时, 移动光标作用。
  - ③结束标定键: 在标定状态下, 当对每一量程标定曲线结束时, 按此键以结束。在测量状态下, 按此键进行曲线校准。
  - ④确认键: 当进行曲线标定或校准时, 按此键对所输入的标准浊度值进行确认。
  - ⑤测试键: 样品测试状态, 由 LED 指示灯指示。
  - ⑥量程键: 在测定过程中切换量程, LED 指示灯指示。
3. 比色池盖: 按盖后部即可开启盖门。
4. 标定/测量拨动开关: 标准浊度标定及样品测试切换开关。
5. 后面板结构

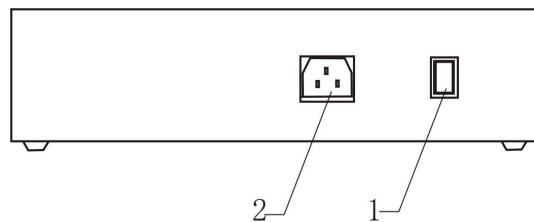

图二 后面板示意图

①电源开关      ②电源插座

## 四、试剂配制：

1. 零度水(无浊水)：将蒸馏水通过  $0.2 \mu\text{m}$  滤膜过滤，收集于用滤过水荡洗两次的玻璃瓶中。
2. 硫酸肼溶液(1g/100mL)：称取 1.000g 硫酸肼(AR)溶于零度水，定容至 100mL。
3. 六次甲基四胺溶液(10g/100mL)：称取 10.00g 六次甲基四胺(AR)溶于零度水，定容至 100mL。
4. 浊度标准贮备液：准确移取 5.00mL 硫酸肼溶液和 5.00mL 六次甲基四胺溶液于 100mL 容量瓶中，混匀。于  $(25 \pm 3)^\circ\text{C}$  下静置 24h，冷至室温后用零度水稀至刻度，混匀。此溶液浊度为 400 度。可保存一个月。

注：如果需要其他浊度标准溶液，即可采用 400 浊度溶液进行稀释，达到所需浊度。

## 五、使用方法

### (一) 浊度测量

1. 开机预热 30min 后，将“标定/测量”拨动开关置于测量处。
2. 按“键头”键选择适当的量程。(为减小误差，尽量选用低量程，但也不能超量程)。
3. 缓慢注入约 50mL 被测样品，用滤纸擦净样杯。
4. 将样杯平稳置入比色池，关闭比色池盖。
5. 待显示数据稳定后，即可读取被测溶液的浊度值。
6. 读数后立即取出样杯，等待下一个样品的测量或关机。

注：在测定样品过程中，如所测样品不在同一个量程范围，则按“量程”键进行量程切换。(另：为保证测量重复性的良好，样杯的宽定位条务必面向使用者)

### (二) 浊度曲线校准及标定

仪器在出厂时已经标定好曲线，一般情况下，即可使用。用户在使用中应经常进行曲线校准；或当因故造成偏差，曲线校准后仍无法测量准确时，可对仪器进行标定。

1. 校准（零点不能校准，否则丢失曲线）
  - (1) 将“标定/测量”拨动开关置于测量处，使仪器置于测量状态
  - (2) 取任一标准浊度溶液约 50mL 注入样杯中，用滤纸擦净样杯后置于比色池，关闭比色池盖。

(3) 按“结束标定”键，然后用“箭头”键输入该标准液的标准浊度值(例如：使用100NTU的标准溶液，则输入“0100”即可)，然后按“确认”键，待读数稳定后，再按“确认”键进行确认。则校准结束。

## 2. 标定

(1) 将“标定/测量”拨动开关置于标定处，使仪器置于标定状态。

(2) 0-5 度量程的标定：

- ① 可选择0度、1度及5度标准浊度液进行标定。
- ② 往样杯中注入约50mL的零度水，擦净样杯后置于比色池。
- ③ 显示“0000”并按“确认”键，待读数稳定后，再按“确认”键进行确认。
- ④ 往样杯中注入50mL的1度标准液，擦净样杯后置于比色池。
- ⑤ 用“箭头”键输入“0001”并按“确认”键，待读数稳定后，再按“确认”键进行确认。
- ⑥ 往样杯中注入50mL的5度(或其它标准浊度值)标准液，擦净样杯后置于比色池。
- ⑦ 用“箭头”键输入“0005”(或其它标准浊度值)并按“确认”键，待读数稳定后，再按“确认”键进行确认。
- ⑧ 按“结束标定”结束对该量程的标定。仪器显示“8888”，此时根据需要按“确认”键进行下一量程的标定；或将“标定/测试”拨动开关拨至测试处进行样品的测量。

(3) 5-25 度量程的标定

- ① 可选择6度、10度及20度两点进行标定。
- ② 往样杯中注入约50mL的6度标准浊度液，擦净样杯后置于比色池。
- ③ 用“箭头”键输入“0006”并按“确认”键，待读数稳定后，再按“确认”键进行确认。
- ④ 往样杯中注入10度(或其它标准浊度值)的标准浊度液，擦净样杯后置于比色池。
- ⑤ 用“箭头”键输入“0010”(或其它标准浊度值)并按“确认”键，待读数稳定后，再按“确认”键进行确认。
- ⑥ 往样杯中注入20度(或其它标准浊度值)的标准浊度液，擦净样杯后置于比色池。
- ⑦ 用“箭头”键输入“0020”(或其它标准浊度值)并按“确认”键，待读数稳定后，再按“确认”键进行确认。

(8) 按“结束标定”结束对该量程的标定。

(4) 25-100 度量程的标定

标定方法同前，建议选择 30 度、50 度与 100 度三点进行标定。

(5) 100-400 度量程的标定

标定方法同前，建议选择 110 度、200 度与 400 度三点进行标定。

(6) 400-800 度量程的标定

标定方法同前，建议选择 410 度、500 度与 800 度三点进行标定。

(7) 800-1000 度量程的标定

标定方法同前，建议选择 810 度、900 度与 1000 度三点进行标定。

注：用户可根据日常使用量程，进行一段或多段量程进行标定。

## 六、注意事项

1. 放置样杯时要细心平稳，以免将液样溅入样杯室中，若不慎溅入，应立即用滤纸吸干，否则引起数字漂移、跳动
2. 样杯为光学玻璃烧接，易碎和划伤，也易被污染，需妥善保管和谨慎使用。样杯的一侧有定位条，定位条底端为 50mL 标准注入量的液位线。测定时液体注入量不能太高或太低，太高了易溢出，太低了会影响准确度。
3. 样杯应保持清洁，取、放样杯时，用两指捏住样杯顶部的两侧玻璃条，避免触及样杯透光部分。每次测完后，应及时取出样杯。
4. 测量时应尽量保持样杯垂直下落，并紧贴样杯室的同一侧面，同时样杯要保证宽定位条面向使用者，以保证重现性的良好。
5. 当水样温度比室温低太多时，会引起样杯玻璃雾化，此时可将水样停放一段时间，待恢复到室温时再测定。
6. 水样应缓慢注入样杯中，以免产生气泡。若样品中气泡太多，可稍待片刻再进行测量，否则，气泡将会影响测量值的稳定。
7. 仪器应放置在干燥通风处，同时需避免强光直射。长期不用时，将样杯擦拭干净置于机外，样杯室内放置硅胶，以保证机内干燥，保护光学元件。
8. 仪器连续开机不宜超过 4h。
9. 样杯可用酒精、洗洁精等洗涤剂清洗，切忌用强酸、强碱等溶剂洗涤。
10. 当仪器显示“EEE1”，表示比色池内未置入样杯或样品不在该量程。  
当仪器显示“EEE2”，表示仪器标定错误。  
当仪器显示“EEE3”，表示仪器校准错误。

## 七、 常见故障及排除

现象	可能原因	排除方法
电源指示灯不亮	①电源没插好或插头与插座接触不良 ②保险丝烧断	①检查插头、插座，重新接好电源 ②更换保险丝
样杯放不进	样杯正反方向错了	重新正确放入
重现性不好	①样杯每次放置时没靠同一侧面 ②液样量相差太大	①重新放置样杯并保持同一侧面 ②保持同一液样量
读数不稳定	①样杯室内有液滴及样杯外有水珠 ②水样中有气泡	①用滤纸擦干 ②待没有气泡再置入样杯室内
误差大	曲线偏离或标定误差	重新校准或标定曲线

## 八、 装箱清单

序号	名 称	单 位	数 量	备 注
1	主机	台	1	
2	样杯	个	1	
3	使用说明书	份	1	
4	保修卡	份	1	
5	产品合格证	份	1	
6	电源线	根	1	